

¿CÓMO COMPLETAR LA SOLICITUD DE CALIBRACIÓN ON-LINE?

MANUAL DE USUARIO. SOLICITUD DE CALIBRACIÓN ONLINE

Para cualquier duda o aclaración:
laboratorio@cnta.es | 948 670 159

OTROS MANUALES DISPONIBLES:

MANUAL DE USUARIO ZONA PRIVADA

¿CÓMO CREAR UNA NUEVA MUESTRA?

¿CÓMO CREAR UNA PLANTILLA DE ANÁLISIS?

CONSULTA DE RESULTADOS / INFORMES

PASO 0

Ir a la página <http://zonaprivada.cnta.es> o bien acceder desde la web www.CNTA.es.

Si ya está registrado en nuestro sistema deberá introducir su nombre de usuario y contraseña, en caso contrario se deberá dar de alta y esperar a recibir los datos de acceso.



PASO 1

Seleccionar en el apartado de **SOLICITUD ONLINE** la opción “**Nueva calibración**” y aparece el paso 1. Datos de la calibración:

INICIO SOLICITUDES PRECARGADAS + NUEVA MUESTRA + **NUEVA CALIBRACIÓN**

Paso 1. Datos de la calibración

| | |
|---|-------------------------------------|
| Descripción equipo (*) | |
| <input type="text"/> | |
| ¿Dónde se va a realizar la calibración? (*) | Marca |
| -- Seleccionar opción -- | <input type="text"/> |
| Modelo | Nº de Serie (*) |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Código interno (*) | Campo de medida |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| División de escala | Puntos de calibración (*) |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Observaciones | Proyecto |
| <input type="text"/> | "Métodos rápidos, jornada CNTA-3M." |

(*) Campos obligatorios

Tendremos dos opciones:

1. **El equipo se calibra en CNTA**> En el campo “donde se va a realizar la calibración” se selecciona “CNTA”.
2. **El equipo se calibra en las instalaciones de la empresa solicitante**> En el campo “donde se va a realizar la calibración” se selecciona “IN SITU”.

PASO 2

En el paso 2. Datos de los métodos, se debe seleccionar el método de calibración con el que se va a calibrar el equipo.

Paso 2. Datos de los métodos

Equipo: **sonda PT100**

Buscador

Selección de calibraciones por categorías

✓ MÉTODOS-CALIBRACIONES (DESPLEGAR LISTADO)

(*) Seleccione al menos un método

Métodos seleccionados

0 método/s seleccionadas

Para seleccionar el método pinchamos sobre “**MÉTODOS-CALIBRACIONES (DESPLEGAR LISTADO)**” y aparece el listado de métodos de calibración y un método de verificación de equipo:

Buscador

Métodos seleccionados

0 método/s seleccionadas

Selección de calibraciones por categorías

✓ **MÉTODOS-CALIBRACIONES (DESPLEGAR LISTADO)**

- > Calibración de autoclave
- > Calibración de balanza
- > Calibración de conductímetro
- > Calibración de estufas
- > Calibración de manómetros y vacuómetros
- > Calibración de micrómetros con bloques patrón
- > Calibración de pesadoras dinámicas (rango 0 - 5 Kg)
- > Calibración de pesadoras multicabezal (máx. 14 cabezales) (rango 0 - 5 Kg)
- > Calibración de pie de rey con bloques patrón
- > Calibración de refractómetro de cloruro sódico
- > Calibración de refractómetro de sacarosa
- > Calibración de temperatura
- > Calibración electrodo de pHmetro
- > Verificación de equipos

Seleccionamos el método y le damos a enviar (en el ejemplo siguiente seleccionamos el método de temperatura):

Buscador

Selección de calibraciones por categorías

✓ **MÉTODOS-CALIBRACIONES (DESPLIEGAR LISTADO)**

- > Calibración de autoclave
- > Calibración de balanza
- > Calibración de conductímetro
- > Calibración de estufas
- > Calibración de manómetros y vacuómetros
- > Calibración de micrómetros con bloques patrón
- > Calibración de pesadoras dinámicas (rango 0 - 5 Kg)
- > Calibración de pesadoras multicabezal (máx. 14 cabezales) (rango 0 - 5 Kg)
- > Calibración de pie de rey con bloques patrón
- > Calibración de refractómetro de cloruro sódico
- > Calibración de refractómetro de sacarosa
- ✓ **Calibración de temperatura**
- > Calibración electrodo de pHmetro
- > Verificación de equipos

(*) Seleccione al menos un método


Métodos seleccionados

1 método/s seleccionadas

MÉTODOS-CALIBRACIONES (DESPLIEGAR LISTADO) > **Calibración de temperatura**

PASO 3

Una vez enviada la solicitud llegamos al apartado de **SOLICITUDES PRECARGADAS** > [Solicitudes pendientes de enviar.](#)



Solicitudes precargadas

Zona privada > Solicitud precargadas

INICIO SOLICITUDES PRECARGADAS NUEVA MUESTRA NUEVA CALIBRACIÓN

Solicitudes pendientes de enviar

| Productos | Nº envases | Lote | Clave | Análisis | |
|---|------------|------|-------|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> sonda PT100 | - | - | | <input type="button" value="ver métodos (1)"/> | <input type="button" value="Opciones"/> |

Enviar muestras

Seleccione delegación / planta

CNTA: AT TECN. PRODUCCION


Plantillas de análisis guardadas

Al crear una muestra desde estas plantillas se cargarán los análisis guardados

No dispone de plantillas guardadas. Cree una solicitud y guárdela como plantilla antes de enviar.

NOTAS

- ✓ Podemos ir cargando tantas calibraciones como deseemos en el apartado de **SOLICITUDES PRECARGADAS** y se guardarán en dicha zona, es decir, cuando salimos de la sesión **NO SE BORRAN**, por lo que nos permite poder pre-cargar todas las que queramos y tenerlas preparadas para cuando las queramos enviar.
 - Para ello desde el apartado **“Opciones”** es posible duplicar cada solicitud y una vez duplicada es posible modificar los campos y características del equipo.

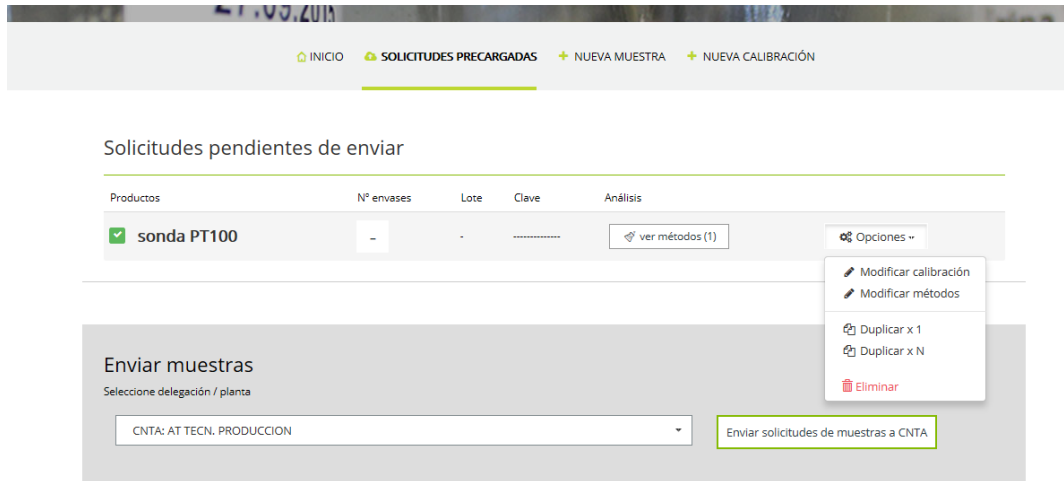

The screenshot shows the 'Solicitudes pendientes de enviar' section of the CNTA web application. At the top, there is a navigation bar with links for 'INICIO', 'SOLICITUDES PRECARGADAS', 'NUEVA MUESTRA', and 'NUEVA CALIBRACIÓN'. Below this, a table lists pending requests with columns for 'Productos', 'Nº envases', 'Lote', 'Clave', and 'Análisis'. A single row is visible for 'sonda PT100' with a green checkmark in the 'Productos' column. To the right of the table, there is a 'ver métodos (1)' button and an 'Opciones' dropdown menu. The dropdown menu contains the following options: 'Modificar calibración', 'Modificar métodos', 'Duplicar x 1', 'Duplicar x N', and 'Eliminar'. Below the table, there is a section titled 'Enviar muestras' with the subtitle 'Seleccione delegación / planta'. A dropdown menu is set to 'CNTA: AT TECN. PRODUCCION', and a button labeled 'Enviar solicitudes de muestras a CNTA' is highlighted with a green box.

PASO 4

Una vez cargadas las calibraciones debemos **SELECCIONAR** las que deseamos enviar a CNTA a través del check de color verde de la parte izquierda y seleccionar la **DELEGACIÓN/PLANTA** a la que se le asignarán.

Después, pulsar el botón “**enviar solicitudes de muestras a CNTA**”.

PASO 5

En este a paso se muestra un **RESUMEN FINAL**, es decir, todavía la solicitud no ha sido enviada a CNTA. Debemos revisar que la información es correcta y si es necesario cumplimentar los **DATOS DE IDENTIFICACIÓN OPCIONALES** (podemos indicar el N^o de pedido para tener mejor trazabilidad y observaciones de envío).

Resumen final

Compruebe los datos antes de enviarlos a CNTA

[← cancelar](#)

Su solicitud no se ha enviado todavía, compruebe los datos antes de enviarla

Resumen final

| Productos | Nº envases | Lote | Clave |
|----------------------------------|------------|------|-------|
| > sonda PT100 | - | | ----- |
| Métodos (1 seleccionados) | | | |
| ☑ Calibración de temperatura | | | |


Datos de identificación. OPCIONALES

Pedido

Observaciones

⚠ POR FAVOR, REVISE BIEN LOS DATOS INTRODUCIDOS. UNA VEZ EMITIDO EL INFORME DE ENSAYO, ÉSTOS NO PODRÁN SER MODIFICADOS.

📄 IMPORTANTE Recuerde que debe descargar e imprimir el PDF resumen de las muestras y adjuntarlo al envío. Podrá descargarlo cuando pulse en "Enviar solicitudes a CNTA".

Enviar solicitudes a CNTA 

Sonda 1 termorregistrador

156489

| | | | |
|---|-----------------------------|---|---|
| Fecha de petición 19/06/2019 Enviado por | Plazos Normal | Empresa CNTA: AT TECN. PRODUCCION (00758) | Delegación CNTA: AT TECN. PRODUCCION (812) |
| Marca Ellab Modelo E-VAL FLEX | Nº de serie 45449 | Puntos de calibración 30/50/60/70/95/100/116/121/ 130 | Almacenamiento |
| Observaciones | | | |

Métodos solicitados (1)

| |
|------------------------------|
| 1 Calibración de temperatura |
|------------------------------|

RECORDAR

Las solicitudes una vez enviadas desaparecen de solicitudes pre-cargadas y se aparecen en nuestra **ZONA PRIVADA**> **MIS MUESTRAS**> **PENDIENTES/TRABAJANDO**.